




PELVI.LOC® PL-UG - XXS, - XS, - S, - M, - L, - XL



Pro bezpečné použití tohoto výrobku si přečtěte a před prvním použitím prosím dbejte návodu k montáži a použití.

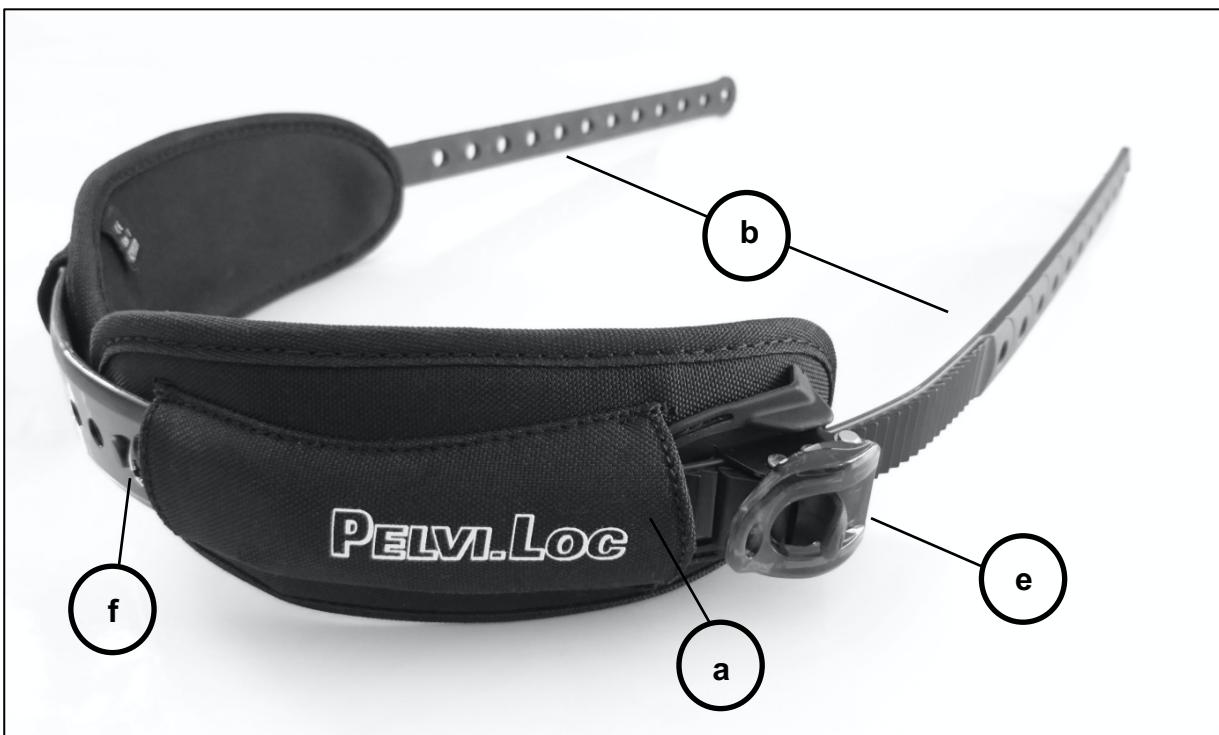

Oblast použití

PELVI.LOC® lýtkový popruh PL-UG slouží osobám s omezenou mobilitou, speciálně pro polohování pánevního stehna v invalidním vozíku a aktivním invalidním vozíku a brání sklouznutí dopředu.

Určená skupina pacientů:

- děti, mládež a dospělé osoby
- pohlaví: ženské a mužské

Kontrola při převzetí

Výrobek kompletně rozbalte a zásilku zkontrolujte z hlediska úplnosti a poškození při přepravě. Pokud byste zjistili, že zásilka oproti očekávání vykazuje vadu, tak:

1. ji okamžitě reklamujte u dopravce
2. nechte škodu / vadu zaznamenat do protokolu
3. okamžitě informujte nás nebo vašeho specializovaného prodejce

Rozsah dodávky

- 1) 1 x **PELVI.LOC® PL-UG, - XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL** předmontováno
- 2) 1 x informace k online stažení návodu k montáži a použití

Kombinace zdravotnických výrobků

Vhodné pro pomůcky, které jsou určeny pro použití pánevního retrakčního pásu

Montáž



Montáž by měla provést osoba s odbornými znalostmi.

1. Polstrování (a) přiložte v oblasti obou lýtka (pod hlavu holenní kosti nebo lýtkové kosti). Ozubený pás (b) přitom leží nahoře.
 - Logo **PELVI.LOC®** na polstrování přitom musí být čitelné zepředu!
2. Vzdálenost polstrování nastavte pomocí děrovaného řemenu (f).
3. Ozubený pás (b) upevněte na trubce rámu invalidního vozíku.
4. Ozubený pás (b) upevněte na obou stranách invalidního vozíku.
5. V případě potřeby mohou být konce ozubeného pásu polokruhově zkráceny. Z konců zkráceného ozubeného pásu odstraňte případné otřepy. – nebezpečí poranění!
6. Zkontrolujte pevné umístění a aretaci na obou stranách ozubeného pásu!



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny

I přes stabilní konstrukci podléhají konstrukční díly, jako jsou děrované popruhy, pásy popruhů, ozubené pásy a polstrování určitému opotřebení. Proto doporučujeme každé tři měsíce **PELVI.LOC®** důkladně kontrolovat. Dbejte přitom také na dotažení nýtovaných a šroubovaných spojů!

- Před použitím se přesvědčte o stavu vhodném k použití a správné poloze výrobku - nebezpečí nehody!
- Poškozené konstrukční díly, jako jsou děrované řemeny / pásy popruhů (f), ozubený pás (b) nebo polstrování (a) neopravujte záplatami, resp. neslepujte a opět nepoužívejte - nebezpečí nehody!
- Na polstrování si nesedejte - nebezpečí otlačených míst speciálně vlivem spon ráčen (e)!
- Invalidní vozík nezvedejte za **PELVI.LOC®** - nebezpečí nehody!
- Dbejte přitom na to, abyste nedávali ruce mezi děrovaný pás a trubku rámu nebo sedadla - nebezpečí přímáčknutí!

Omezení použití / nežádoucí vedlejší účinky

- **PELVI.LOC®** nepoužívejte, když se v oblasti polstrování vyskytuje otlačená místa, trhliny nebo jiná poškození - nebezpečí poranění!
- **PELVI.LOC®** nepoužívejte v případě osteoporózy, řídnutí kostí nebo silného prokrovování - nebezpečí poranění!
- Po vyčištění zajistěte správnou funkci **PELVI.LOC®**!
- Poškozený **PELVI.LOC®** by měl být okamžitě vyměněn - nebezpečí nehody!



Pozor:

- **PELVI.LOC®** není součástí zádržného systému pro invalidní vozíky a/nebo cestující při přepravě ve vozidle pro přepravu postižených osob.
- Výrobce ani distributor nemohou být ve smyslu zodpovědnosti za výrobek zodpovědní za škody nebo rizika, která budou způsobena v souvislosti s výrobkem dětmi, které nejsou pod dohledem!

Použití

1. K použití **PELVI.LOC®** je polstrování (a) pokládáno na lýtka.



Pozor: Dbejte na to, aby se pod polstrováním nenacházely žádné předměty! Zabráňte tak bolestivým otlakům.

2. Poté ozubený pás (b) veďte skrz příslušnou ráčnu. Pro tento účel stiskněte příslušnou sponu ráčny (e).
 3. Následně ozubený pás (b) napněte natolik, aby bylo mezi lýtka a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
 4. Zajistěte, aby spony ráčen (e) zasahovaly do zubů ozubeného pásu!
- Proveďte zkoušku tahu!

K otevření PELVI.LOC® stiskněte tlakovou sponu (e) a vytáhněte ozubený pás.

- Dbejte na to, aby se polstrování nedostalo mezi špice hnacího kola!

Čištění a dezinfekce

- Vhodné k praní v pračce do 40 stupňů.
- Chemicko-teplelná dezinfekce je možná přidáním ELTRA 40 do prací operace.
- Neždímejte.
- Nevhodné do sušičky.

Údržba

PELVI.LOC® pravidelně kontrolujte z hlediska poškození a funkčnosti.

Opravy

Vadný **PELVI.LOC®** okamžitě vyměňte.

Likvidace

- Obal přístroje může být předán k recyklaci druhotných surovin.
- Kovové díly mohou být předány k recyklaci použitých kovů.
- Plastové díly mohou být předány k recyklaci plastů.
- Likvidace musí probíhat dle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Zeptejte se prosím správy vašeho města/obce na místní likvidační podniky.



Technické údaje

	XXS	XS	S	M	L	XL
Šířka kolen (cm)	12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Velikost polstrování (cm)	11,5 x 7,5	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Hmotnost (g)	200	220	220	280	280	280
Stanovené místo lomu (při cca kg)	60	60	60	80	80	80

Ozubený pás vel. XXS - XS - S	1,9 x 0,2 x 19,5 cm
Ozubený pás vel. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 22,5 cm

Výrobek



neobsahuje latex

Důležité upozornění: Šířka kolen není šířka sedu!

Podmínky skladování a přepravy

	Teplotní rozsah pro dlouhodobé skladování od -10 °C do +40 °C. Krátkodobé teplotní výkyvy, např. během přepravy, od -20 °C do +60 °C materiál dobře snáší a nemají vliv na bezpečnost a výkonnost výrobku.
	Chraňte před vlhkostí během skladování a přepravy

Záruční plnění

Za tento výrobek přebíráme zodpovědnost dle zákonného ustanovení. Ta se týká materiálových a výrobních vad. Jsou z ní vyloučeny opotřebitelné díly a díly/konstrukční skupiny, které podléhají stanovenému opotřebení, stejně jako škody, které vyplynou v důsledku nadměrného namáhání, použití v rozporu s určením, násilného poškození nebo nepřípustných změn/oprav. V případě záručního plnění se prosím obraťte na vašeho specializovaného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Z důvodu zodpovědnosti za výrobek smí být opravné, údržbové a servisní práce prováděny jen autorizovanými specializovanými prodejci s použitím originálních náhradních dílů.



Výrobce:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Tel.: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276
Email: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com

Tento výrobek splňuje Základní požadavky ES
Směrnice o zdravotních prostředcích (EU)
2017/745.

Stav 20.05.2021

Technické změny vyhrazeny