




PELVI.LOC® PL-3DWP – XXS - XS - S - M - L



Pro bezpečné použití tohoto výrobku si přečtěte a před prvním použitím prosím dbejte návodu k montáži a použití.

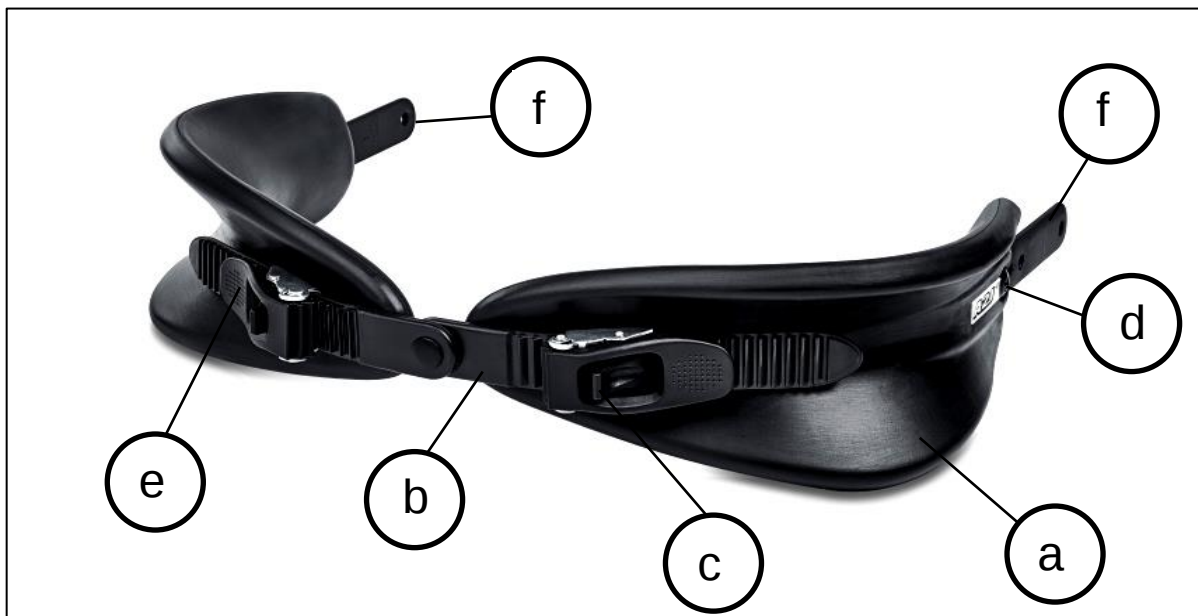

Oblast použití

Tento **PELVI.LOC®** PL-3DWP Waterproof slouží k polohování a retrakci pánve pro osoby s omezenou mobilitou na sedací ploše, např. sprchovací invalidní vozík, koupací lehátko, invalidní vozík, sedací skořepina, terapeutická židle, rehabilitační kočárek, sportovní přístroj

Určená skupina pacientů:

- děti, mládež a dospělé osoby
- pohlaví: ženské a mužské

Kontrola při převzetí

Výrobek kompletně rozbalte a zásilku zkontrolujte z hlediska úplnosti a poškození při přepravě. Pokud byste zjistili, že zásilka oproti očekávání vykazuje vadu, tak:

1. ji okamžitě reklamujte u dopravce
2. nechte škodu / vadu zaznamenat do protokolu
3. okamžitě informujte nás nebo vašeho specializovaného prodejce

Rozsah dodávky

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DWP – XXS, -XS, -S, -M, -L předmontováno
- 2) 1 x informace k online stažení návodu k montáži a použití

Kombinace zdravotnických výrobků

Vhodné pro pomůcky, které jsou určeny k použití pánevního retrakčního pásu

Montáž



Montáž by měla provést osoba s odbornými znalostmi.

1. Polstrování (a) přiložte vždy v oblasti pánve / kyčelního záhybu. – Ozubené kolo (b) přitom leží nahoře.
 - Logo na polstrování přitom musí být k přečtení na levé straně.
2. Vzdálenost polstrování nastavte pomocí ozubeného pásu (b) stisknutím spony ráčny (e).
 - Kloub ozubeného pásu by se pak měl nacházet uprostřed mezi polstrováním.
 - Ozubený pás musí být max. natolik vytažený, aby byly ještě dva zuby za každou západkou (c) volné.
3. Následně umístěte děrované řemeny (f) na trubce rámu invalidního vozíku.
4. Ozubený pás (b) na obou stranách napněte stejně a natolik, aby bylo mezi stehem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
5. V případě potřeby mohou být konce ozubeného pásu polokruhově zkráceny. Z konců zkráceného ozubeného pásu odstraňte případné otřepy. – nebezpečí poranění!
6. Zkontrolujte pevné umístění a aretaci na obou stranách ozubeného pásu!



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny

I přes stabilní konstrukci podléhají konstrukční díly, jako jsou děrované popruhy, ozubené pásy a polstrování určitému opotřebení. Proto doporučujeme každé tři měsíce **PELVI.LOC®** PL-3DWP důkladně zkontrolovat. Dbejte přitom ještě na dotažení nýtovaných a šroubovaných spojů!

- Před použitím se přesvědčte o stavu vhodném k použití a správné poloze výrobku - nebezpečí nehody!
- Poškozené konstrukční díly, jako jsou děrované řemeny (f), ozubený pás (b) nebo polstrování (a) neopravujte záplatami, resp. nelepte a opět nepoužívejte - nebezpečí nehody!
- Na polstrování si nesedejte - nebezpečí otlacených míst především vlivem ráčen (e)!
- Invalidní vozík nezvedejte pomocí **PELVI.LOC®** PL-3DWP - nebezpečí nehody!
- Dbejte přitom na to, abyste nedávali ruce mezi děrovaný řemen a trubku rámu nebo sedadla - nebezpečí přimáčknutí!

Omezení použití / nežádoucí vedlejší účinky

- **PELVI.LOC**® PL-3DWP nepoužívejte, když se v oblasti polstrování vyskytují otlačená místa, trhliny nebo jiná poškození - nebezpečí poranění!
- **PELVI.LOC**® PL-3DWP nepoužívejte v případě osteoporózy, řídnutí kostí nebo silného prokrvování - nebezpečí poranění!
- Po vyčištění zkontrolujte správnou funkci **PELVI.LOC**® PL-3DWP!
- Poškozený **PELVI.LOC**® PL-3DWP by měl být okamžitě vyměněn - nebezpečí nehody!



Pozor:

- **PELVI.LOC**® PL-3DWP není součástí zádržného systému pro invalidní vozíky a/nebo cestující při přepravě ve vozidle pro přepravu postižených osob.
- Výrobce ani distributor nemohou být ve smyslu ručení za výrobek zodpovědní za škody nebo rizika, která budou způsobena v souvislosti s výrobkem dětmi, které nejsou pod dohledem!

Použití

1. K použití **PELVI.LOC**® PL-3DWP je polstrování (a) pokládáno na stehna.



Pozor: Dbejte na to, aby se pod polstrováním nenacházely žádné předměty! Zabráňte tak bolestivým otlakům.

2. Poté ozubený pás (b) ved'te skrz příslušnou ráčnu. Pro tento účel stiskněte příslušnou sponu ráčny (e).
3. Následně ozubený pás (b) napněte natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
4. Zajistěte, aby západky (e) zasahovaly do zubů ozubeného pásu!
 - Proveďte zkoušku tahu!

Pokud dojde během používání **PELVI.LOC**® PL-3DWP k nechtěnému uvolnění polohovacího systému, pak to může být odstraněno opětovným napnutím.

K otevření **PELVI.LOC® PL-3DWP** stiskněte tlakovou sponu (e) a vytáhněte ozubený pás.

- Dbejte na to, aby se polstrování nedostalo mezi špice hnacího kola!

Čištění a dezinfekce

- Mycí dezinfekce s použitím ISOPROPANOL 70 %
- Nepoužívejte žádný aceton nebo mycí benzín!

Údržba

PELVI.LOC® PL-3DWP pravidelně kontrolujte z hlediska poškození a funkčnosti.

Opravy

Vadný **PELVI.LOC**® okamžitě vyměňte.

Likvidace


- Obal přístroje může být předán k recyklaci druhotných surovin.
- Kovové díly mohou být předány k recyklaci použitých kovů.
- Plastové díly mohou být předány k recyklaci plastů.
- Likvidace musí probíhat dle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Zeptejte se prosím správy vašeho města/obce na místní likvidační podniky.

Technické údaje

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Délka sedadla (cm)		16 - 24	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Velikost polstrování (cm)		14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	
Hmotnost (g)		220	220	220	280	280	
Stanovené místo lomu (při cca kg)		40	60	60	80	80	

Ozubený pás vel. XXXS - XXS	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	bez latexu  
Ozubený pás vel. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	
Ozubený pás vel. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm	
Spona ráčny vel. XXXS		
Spona ráčny vel. XXS	B-19-ERGO-BL	
Spona ráčny vel. XS - S	B-19-ERGO-BL	
Spona ráčny vel. M - XL	B-24-ERGO-BL	

Skladovací a přepravní podmínky

	Teplotní rozsah pro dlouhodobé skladování od -10 °C do +40 °C. Krátkodobé teplotní výkyvy, např. během přepravy, od -20 °C do +60 °C materiál dobře snáší a nemají vliv na bezpečnost a funkčnost výrobku.
	Chraňte před vlhkostí během skladování a přepravy

Záruční plnění

Za tento výrobek přebíráme záruku v souladu se zákonnými ustanoveními. Vztahuje se na vady materiálu a chyby zpracování. Nevztahuje se na opotřebitelné díly a díly/sestavy, které podléhají běžnému opotřebení, jakož i na poškození vzniklá nadměrným namáháním, „používáním v rozporu s určením“, poškozením způsobeným násilím nebo neschválenou úpravou/opravou. V případě záručního plnění se obraťte na specializovaného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Z důvodu odpovědnosti za výrobek mohou opravy, údržbu a servisní práce provádět pouze autorizovaní specializovaní prodejci s použitím originálních náhradních dílů



Výrobce:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

E-mail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Tento výrobek je v souladu se základními požadavky nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích - Medical Device Regulation (MDR)

Stav 01.01.2025

Technické změny vyhrazeny