


PELVI.LOC®

PL - OPS - Made to measure upper body positioning

Ordine:..... Campione:.....
 Cliente:..... Funzionario:.....
 Indirizzo di spedizione:..... Data dell'ordine:.....
 Numero d'ordine:.....

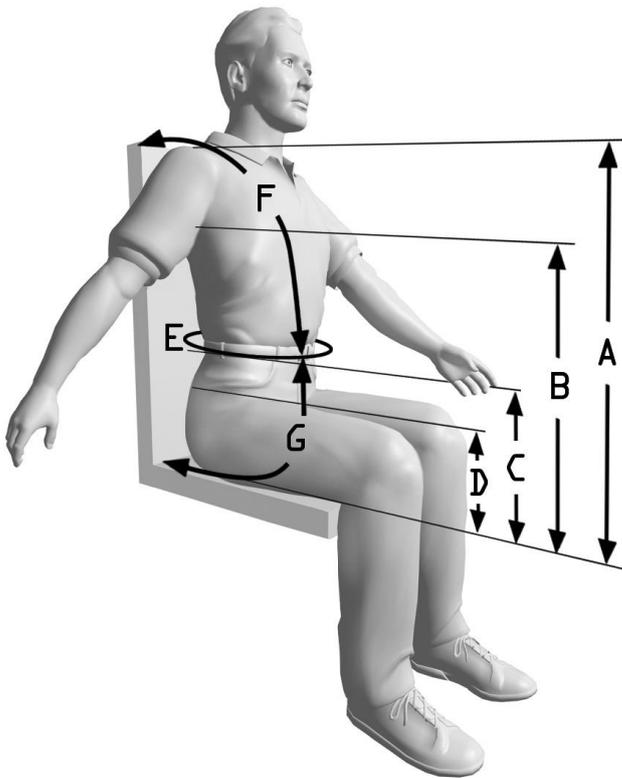

Dimensions

| | | |
|---|--|----|
| A | Sedile - spalla | cm |
| B | Sedile - altezza ascella | cm |
| C | Sedile - vita | cm |
| D | Sedile - altezza coscia | cm |
| E | Vita - circonferenza | cm |
| F | Spalla - vita | cm |
| G | Dimensione del sedile (schienale - vita) | cm |

Prendere le misure al di sopra degli indumenti senza alcuna aggiunta

| | | |
|---|----|----|
| Altezza schienale | cm | |
| Larghezza schienale | cm | |
| Distanza tra i tubi del poggiatesta | cm | |
| Possibilità di implementazione Sedile - schienale | Si | No |
| Tipo di sedia a rotelle | | |

Tipi di chiusura richiesti

| | |
|---|--------------------------|
| Chiusura a pressione apribile con 2 dita Art. No.:KSS-50 | <input type="checkbox"/> |
| Chiusura pressione apribile con 3 dita Art. No.:KSS-S-50 | <input type="checkbox"/> |
| Chiusura pressione apribile con 3 dita rivolta verso l'interno Art. No.:KSS-S-50 180° | <input type="checkbox"/> |
| SKS-30-SF Serratura a innesto con funzione di sicurezza (apertura con perno) | <input type="checkbox"/> |

Info:.....

Delivery time about one week after your order